


DOLAŞIM SİSTEMİ ORGANLARI PANOSU

Cihaz Özellikleri		Cihaz sorumlusu	
Markası/ modeli	General Doctor	Adl Soyadı	Arş. Gör. Dr. Emine GÜNEŞ ŞAN
Demirbaş sicil no	255.1.5/19/32554	Telefon	(0378) 223 53 89
Cihaz durumu/ adedi	Aktif/ 1 adet	e-posta	esan@bartin.edu.tr
Bulunduğu Laboratuvar	Sağlık Bilimleri Fakültesi/ Anatomi Laboratuvarı		

Cihaza Ait Resimler

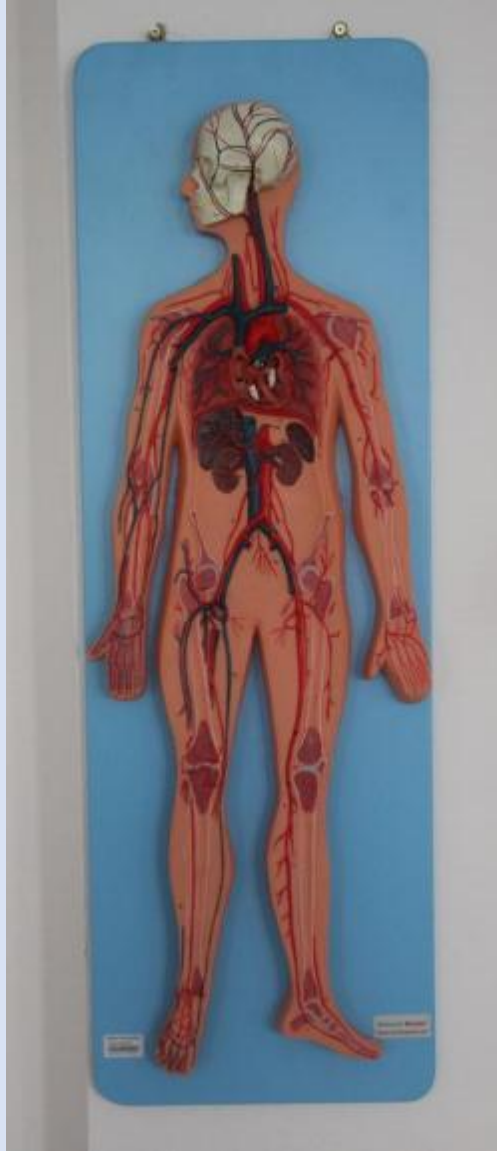

Teknik Özellikler

1. Bir plaka üzerinde gerçeğe uygun yapıdadır.
2. Tam boy insanın 1/2 büyüklüğünde frontal düzlemde şekillendirilmiştir.
3. Dikey yüzeylerde sergilenmektedir.
4. Dayanıklı plastik malzemeden imal edilmiştir.